ＣＰＲ蘇生マスク
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 本品は１回限りの使用で、再使用しないでください。
2) 使用目的以外に使用しないでください。
3) 発火のおそれのある場所で酸素吸入はしないでください。
4) 救急蘇生に習熟した方以外は使用しないでください。
5) 材質に過敏症がある傷病者には使用しないでください。
6) 破損のおそれがありますので、本品を分解しないでください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

本品はポケットサイズのマウス･ツウ･マスク法の蘇生マスクです。

【各部の名称】

【一方向弁の原理】
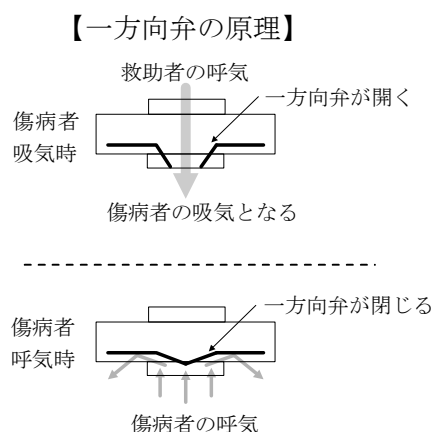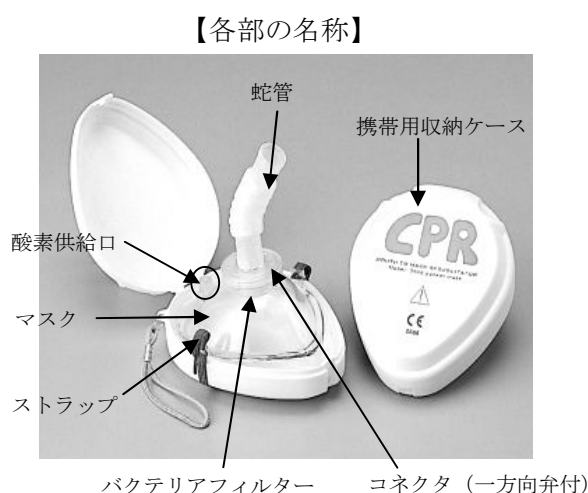
【材質】
①マ　ス　ク：ポリ塩化ビニル（可塑剤；フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）
②ストラップ：ポリエステル系繊維（ラテックスフリー）
③蛇　　　管：ポリプロピレン

3. 使用前の準備に関する事項

1) マスクが変形していないか、また鼻･口を覆うクッション機構に異常がないか確認してください。
2) マウス･ツー･マウス法に則って蛇管を吹き、マスクから空気が出ていること、一方向弁の機能が正常に働いていることを確認してください。

4. 一般的な使用方法とその注意事項

1) 収納状態のマスクを反対側に押し出してください。
次に、蛇管をマスクに装着してください。
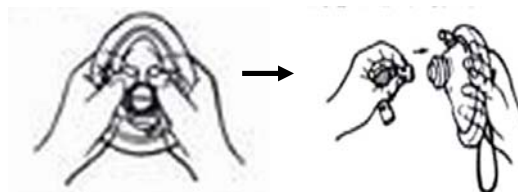
2) 傷病者の鼻と口を覆うように、親指と人差指（又はストラップ）でマスクを固定してください。

2012 年 7 月 2 日改訂　　　　村中医療器株式会社

3) 蛇管を口にくわえ、心肺蘇生を行ってください。

注意
蛇管に他の蘇生器を直接装着して使用することも可能です。
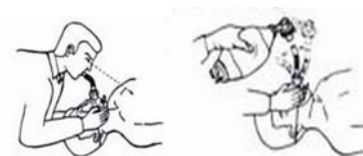
4) 傷病者の胸が膨らむまでゆっくりと息を吹き込み、傷病者に息を吐き出させてください。

注意
傷病者が嘔吐した場合は、ただちにマスクをはずし、口腔内の嘔吐物を取り除いて傷病者の気道を確保してください。

5) 酸素を付加する場合は、マスクの酸素供給口のキャップを外し、酸素チューブを接続してください。

注意
接続できるプラグはユニバーサルタイプのみで、短型タイプは接続できません。

5. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 使用期限
製造年月より3年間有効です［自己認証（当社データによる)］。

6. 技術仕様

重量	約110g(収納ケース含む)
サイズ	W104×D118×H90㎜
コネクタ	一方向弁（ダックビルバルブ）内蔵 外径15㎜
蛇管	内径15㎜
フィルターによる呼気･吸気抵抗	＜5㎝H20(0.49kPa)/分時流量30LPM
使用時の環境条件	周囲温度0～40℃
保管時の環境条件	周囲温度-18～50℃

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者 ：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号
TEL 0725-53-5546
http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品番	商品名
502-014-31	3606	ＭＭＩ ＣＰＲ蘇生マスク